

## 包装仕様変更のお知らせ

経皮吸収型・心疾患治療剤

# バソレーター<sup>®</sup>テープ27mg

(ニトログリセリンテープ)

## VASOLATOR<sup>®</sup> TAPE

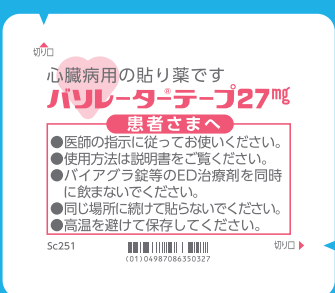
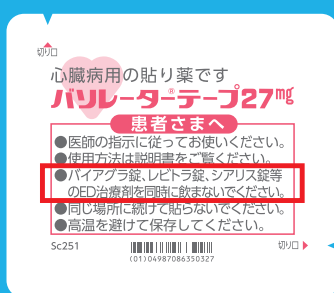
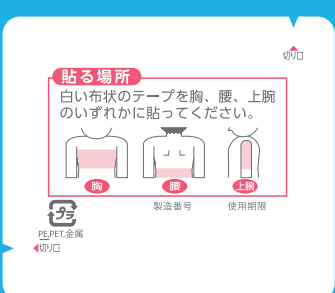
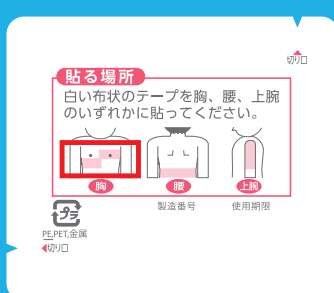
謹啓 平素は弊社製品に対し格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
 さて、このたびご愛顧頂いております経皮吸収型・心疾患治療剤バソレーターテープ27mgにつきまして、薬袋の包装仕様等を変更致しますので下記の通りご案内申し上げます。  
 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### ■変更事項



- ・アルミ包装表面「患者さまへ」の記載事項を一部変更致します。
  - ・アルミ包装裏面「貼る場所」の胸の貼付位置を変更致します。
- ※心臓疾患では、自動体外式除細動器(AED)を必要とする場合がある為、胸部の貼る場所を電極パッドの妨げにならない位置に変更致しました。

変更箇所	変更前	変更後
薬袋	 <p>(表面)</p>	 <p>(表面)</p>
	 <p>(裏面)</p>	 <p>(裏面)</p>

※裏面もご覧下さい。

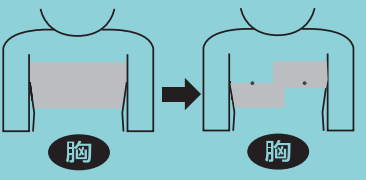
■変更事項

- 同封の患者さま用説明書「パソレーターテープ27mgのご使用にあたって」の記載事項の一部と貼る場所の胸の貼付位置を変更致します。
- 説明書を束ねるフィルムバンド幅を変更致します。

変更箇所	変更前	変更後
患者さま用説明書 (使用方法)	<p><b>パソレーターテープ27mgのご使用にあたって</b> .....</p> <p>パソレーターテープ27mgは、皮膚に貼ることで効果を示す心臓病の薬です。先生の指示に従って、正しく使用してください。</p> <p>注意：この薬を貼る人はバイアグラ錠等のED治療剤を服用しないでください。</p> <p><b>貼る場所</b> 白い布状のテープを胸、腰、上腕のいずれかに貼ってください</p>  <p><b>使う時の注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>この薬を貼る場所は事前にタオル等で水分や汗をよく拭き取ってから貼ってください。</li> <li>傷口、発赤、発疹、かぶれ等のある場所には貼らないでください。</li> <li>同じ場所に続けて貼ると、かぶれ等を生じることがありますので、場所を変えて貼ってください。また、<b>強いかぶれが生じた場合は先生にご相談ください。</b></li> </ul> <p><b>保管について</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>開封後はただちに使用ください。</li> <li>日のあたる場所や、高温（40℃以上）の場所には置かないでください。特に夏期の車内等では60℃を超えることがありますので、絶対に放置しないでください。</li> <li>小児の手の届かないところに保管してください。</li> </ul>	<p><b>パソレーターテープ27mgのご使用にあたって</b> .....</p> <p>パソレーターテープ27mgは、皮膚に貼ることで効果を示す心臓病の薬です。先生の指示に従って、正しく使用してください。</p> <p>注意：この薬を貼る人はバイアグラ錠、レビトラ錠、シアリス錠等のED治療剤を服用しないでください。</p> <p><b>貼る場所</b> 白い布状のテープを胸、腰、上腕のいずれかに貼ってください</p>  <p><b>使う時の注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>この薬を貼る場所は事前にタオル等で水分や汗をよく拭き取ってから貼ってください。</li> <li>傷口、発赤、発疹、かぶれ等のある場所には貼らないでください。</li> <li>同じ場所に続けて貼ると、かぶれ等を生じることがありますので、場所を変えて貼ってください。また、<b>強いかぶれが生じた場合は先生にご相談ください。</b></li> </ul> <p><b>保管について</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>開封後はただちに使用ください。</li> <li>日のあたる場所や、高温（40℃以上）の場所には置かないでください。特に夏期の車内等では60℃を超えることがありますので、絶対に放置しないでください。</li> <li>小児の手の届かないところに保管してください。</li> </ul>
フィルムバンド幅	20mm	30mm

■変更品の識別方法

変更後一定期間下記を表示を致します。

包装	個装箱	患者様へのお知らせ
35枚包装 140枚包装 350枚包装 共通	<b>薬袋・説明書表示変更品</b>	<p>●お知らせ●</p> <p>お薬を胸にはる場所のイラストが変更になりました。胸に貼るときは、イラスト指示の場所にお貼りください。</p>  <p>35枚包装：個装箱に1束（5枚）封入 140枚包装：個装箱に1束（20枚）封入 350枚包装：個装箱に1束（50枚）封入</p>
	梱包箱	
	<b>薬袋・説明書表示変更品</b>	

■変更品出荷予定時期（メーカーコード086）

製品名	包装	統一商品コード	GS1コード		製造番号 (使用期限)	出荷予定 時期※
			販売包装単位コード	調剤包装単位コード		
パソレーターテープ 27mg	35枚 (1枚×35)	086350297			058 (2021年5月)	2018年9月
	140枚 (1枚×140)	086350303			058 (2021年5月)	2018年9月
	350枚 (1枚×350)	086350310			058 (2021年5月)	2018年10月

※変更品の出荷予定時期は、弊社在庫状況により若干の差異が生じることがございますので予めご了承願います。  
なお、成分、効能・効果、用法・用量、統一商品コード、GS1コードは変更ございません。